□□□□PFS□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□PFS□□□□

□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□5cm□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□1□□□□□□□□□□□□□150□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Image

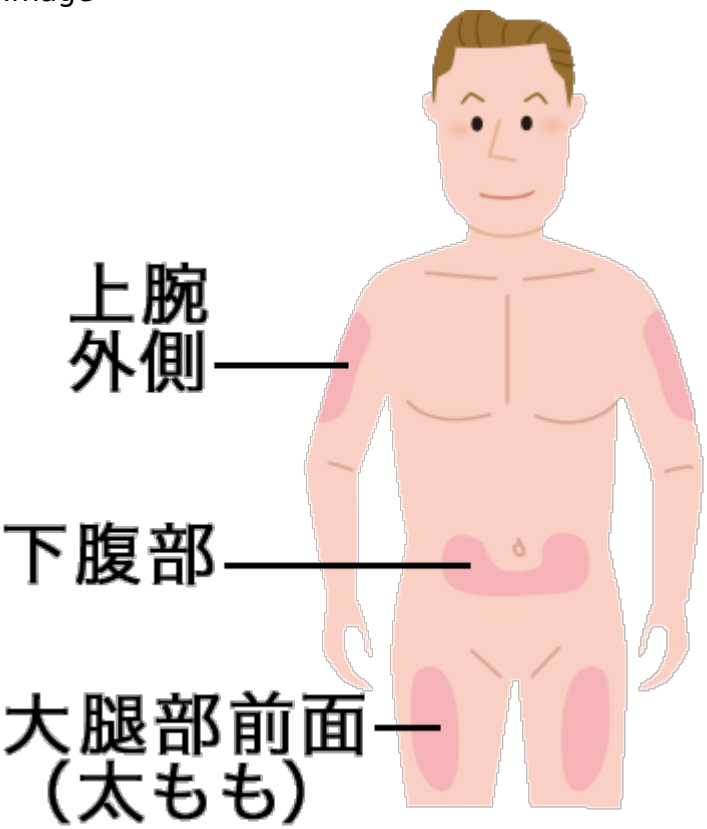

□□□□□□□75mg/150mg□□□□□□□□□□□□□

Image

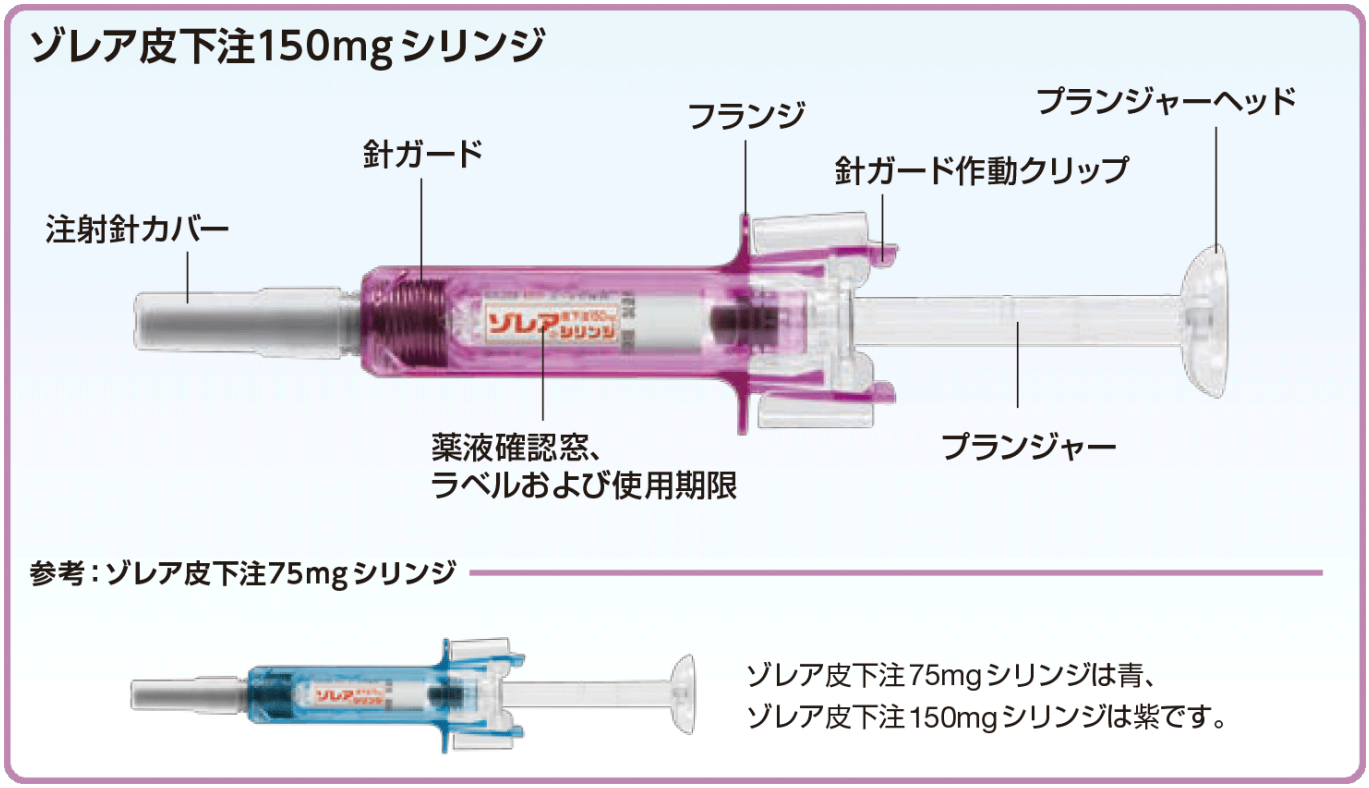
ゾレア皮下注150mgシリンジ
プランジャーヘッド
フランジ
針ガード
針ガード作動クリップ
注射針カバー
薬液確認窓、
ラベルおよび使用期限
プランジャー
参考：ゾレア皮下注75mgシリンジ
ゾレア皮下注75mgシリンジは青、
ゾレア皮下注150mgシリンジは紫です。

□□
• □□□□

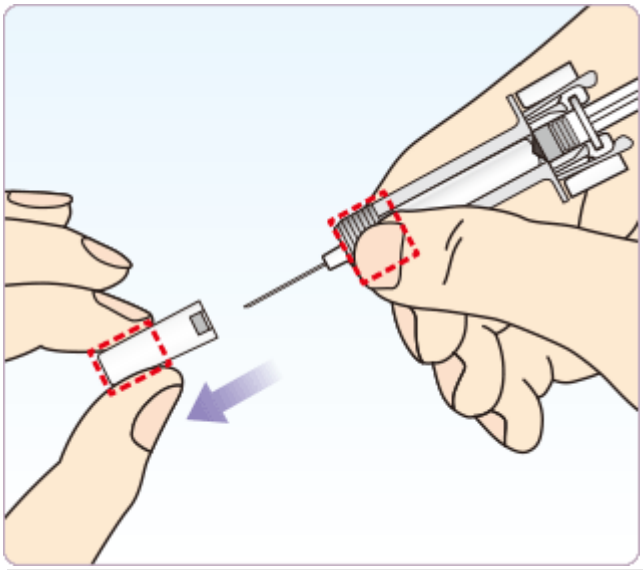

□□
- □□□□

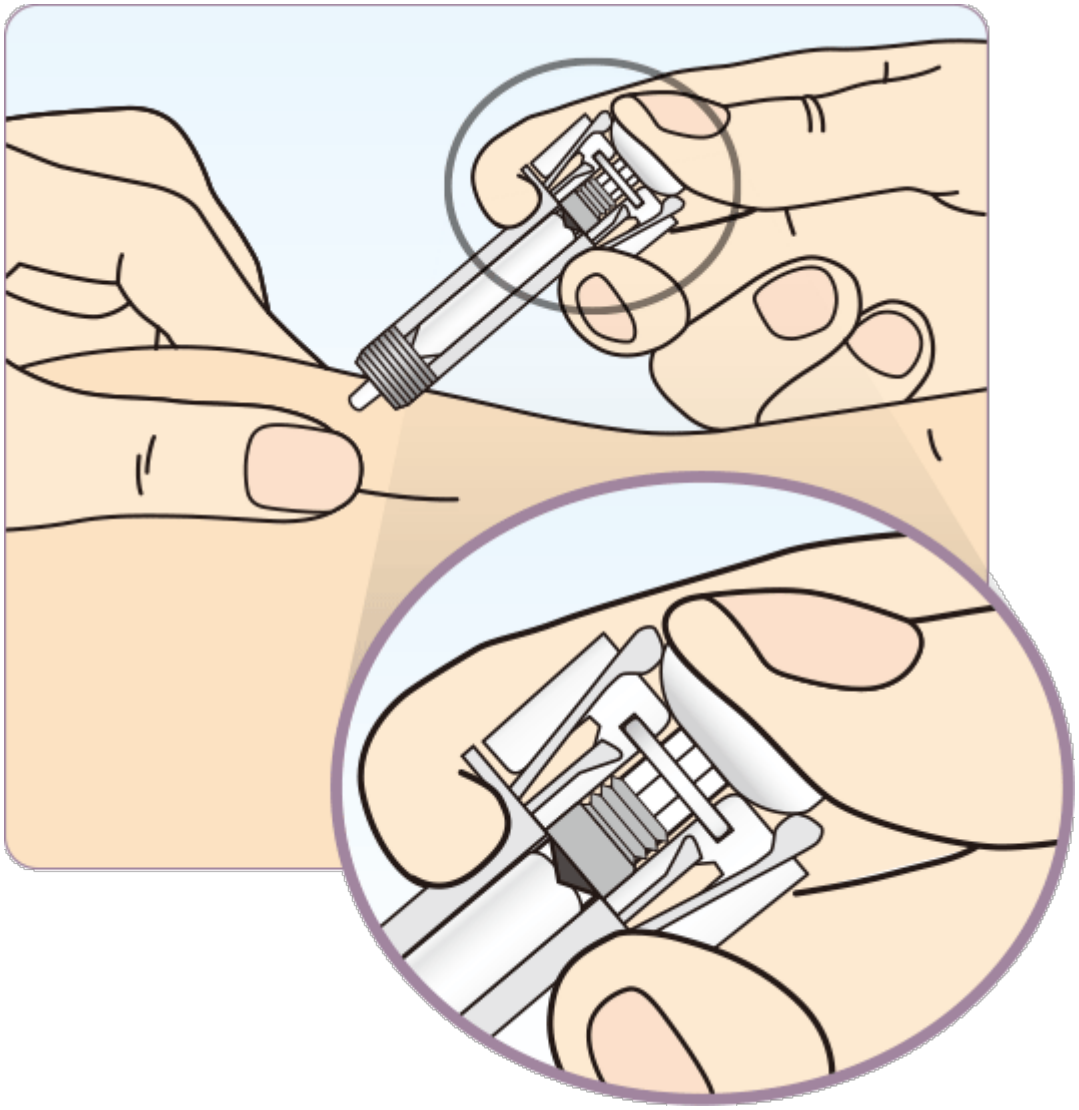

④□□□

□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

IgE□□□□□□

Image

Source URL: *https://www.loadtest.pro.novartis.com/products/xolair/asthma/moa*